



Berührungsloser Desinfektionsmittelspender - Installationsanleitung




1x



A) Inhalt

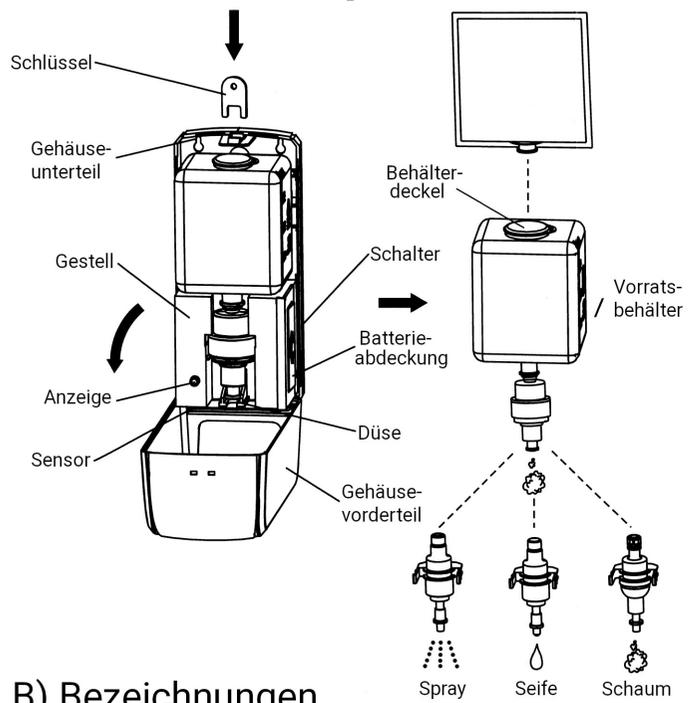


B) Bezeichnungen

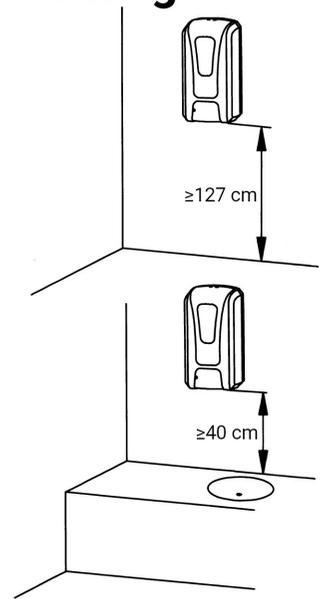


*) nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen

C) Höhe über Boden/Tisch

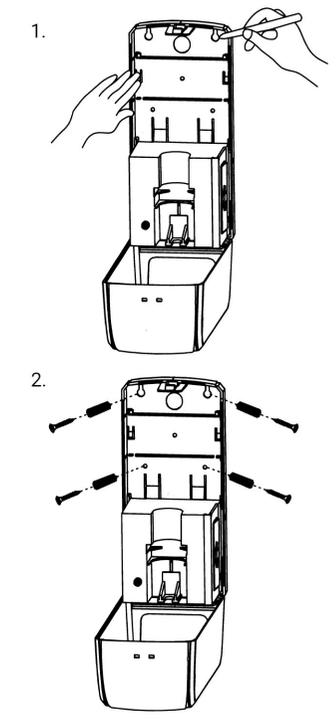


D) Positionen der Schrauben

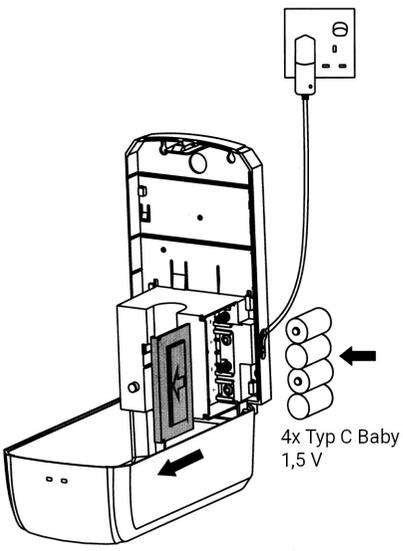

4x Typ C Baby 1,5 V


*) Netzteil und Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

E) Stromversorgung

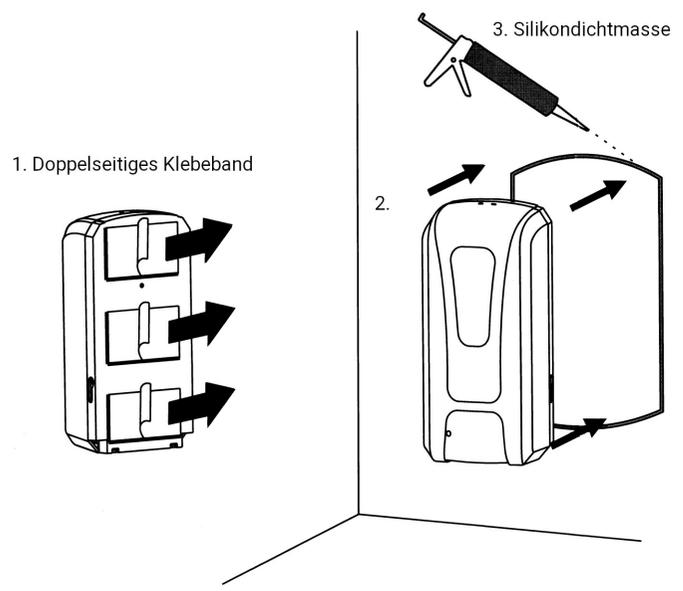


*) Doppelseitiges Klebeband und Silikon nicht im Lieferumfang enthalten

F) Schraubenlose Befestigung

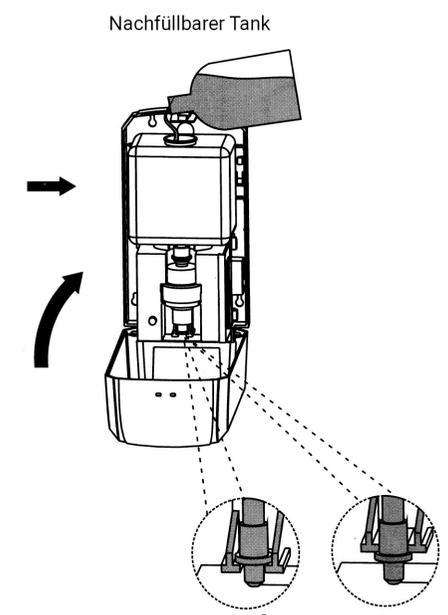

G) Nachfüllen

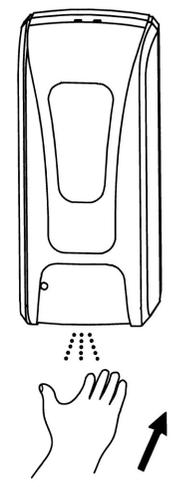

UV Lampe für Desinfektion
LED Anzeige:
1. 5s grün blinkend: normaler Betrieb
2. 5s rot blinkend: niedrige Spannung, Batteriewechsel notwendig
3. 2s rot blinkend: Sensor ist blockiert, Grund entfernen

H) Betrieb